

Résumé de la reconstruction du
service de la réhabilitation de
l'Établissement Communal à But
Non Lucratif «Hôpital Clinique
Régional d'Odessa» du Conseil
Régional d'Odessa»

Exigences pour l'organisation d'un service d'hospitalisation pour la fourniture de soins de réhabilitation :

1. Disponibilité d'une salle pour la thérapie physique.
2. Disponibilité d'une salle pour l'ergothérapie.
3. Disponibilité d'un cabinet de technologies assistives.
4. Disponibilité d'un cabinet pour fournir des soins de réhabilitation individuelle en thérapie du langage et de la parole.
5. Disponibilité d'un cabinet pour fournir une aide psychologique.
6. Disponibilité de toilettes et de douches spacieuses, équipées pour les personnes utilisant des fauteuils roulants.

Équipement de réhabilitation pour la salle de thérapie physique :

- ✓ Tables de traitement larges avec réglage en hauteur – 3 pieces
- ✓ Rotor pour l'entraînement des membres supérieurs et inférieurs
- ✓ Appareil pour l'entraînement des doigts
- ✓ Barres parallèles de réhabilitation avec obstacles
- ✓ Escaliers de réhabilitation avec obstacles
- ✓ Appareil de mobilisation passive du membre inférieur
- ✓ Appareil de mobilisation passive de l'épaule
- ✓ Appareil de mobilisation passive du poignet

Salle de thérapie physique



Table de traitement large avec réglage en hauteur

Table de massage Vojta-Bobath avec entraînement électrique SMB-1



Données techniques

Longueur	2000 mm
Largeur	1200 mm
Hauteur	500... 1000 m
Charge	300 kg

Rotor pour l'entraînement des membres supérieurs et inférieurs

Mécanothérapie motrice simultanée
MOTOmed muvi



Composition

Les modules pour les jambes et les bras / la partie supérieure et inférieure du corps peuvent tourner simultanément ou séparément.

Écran couleur/tactile (12,1")

Pédales-plateformes sécurisées avec revêtement en plastique, poignée et module pour l'entraînement des bras / de la partie supérieure du corps.

Poignée pivotante, réglable en hauteur et en distance par rapport à l'utilisateur, module pour l'entraînement des bras / de la partie supérieure du corps.

Réglage de la fréquence de rotation des pédales de 0 à 60 tr/min (en mode passif)

Réglage de la durée de l'entraînement de 0 à 120 minutes

Appareil pour l'entraînement des doigts des mains

DigiTrainer



Données techniques

Équipement pour la réhabilitation des doigts des mains

Réglage de différentes fréquences de vibration

Réglage de la vitesse

Barres de réhabilitation avec obstacles

Barres de réhabilitation avec obstacles BP-1



Données techniques

Longueur	4000 mm
Largeur	1340...1515 mm
Hauteur	780...1100 mm
Charge	До 120

Escaliers de réhabilitation



Escaliers SX-1 pour la réhabilitation des compétences de marche

Données techniques

Longueur	2980 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	1200...1600 mm
Charge	До 100 kg

Appareil de mobilisation passive de la partie inférieure de la jambe



Fisiotek 3000 TS

Données techniques

Mobilisation de l'articulation de l'hanche, du genou et de la cheville

Plage de mouvements de flexion-extension du genou de 0° à 110°

Plage de mouvement de l'articulation de la hanche de 7° à 115°

Plage de mouvement de l'articulation de la cheville de 20° à 40°

Appareil de mobilisation passive de l'épaule

Fisiotek LT-5R



Données techniques

Élévation lors de la flexion, plage : 0° à 180°

Rotation interne-externe, plage : 90° ÷ 0° ÷ 90

Adduction-abduction : plage physiologique complète

Appareil de mobilisation passive du poignet



Fisitek LT-P

Données techniques

Flexion-extension, plage : $80^{\circ} \div 0^{\circ} \div 80^{\circ}$

Déviaton radiale et ulnaire, plage : $20^{\circ} \div 0^{\circ} \div 30^{\circ}$

Vibrothérapie



Vibromasseur Hypervibe G17 (J17)

Le vibromasseur Hypervibe G17 (J17) est un dispositif équipé d'une poignée pratique pour le soutien pendant la vibrothérapie, utilisé dans le cadre de la réhabilitation des adolescents diagnostiqués avec la paralysie cérébrale, des adultes après un AVC ou pour des pathologies du dos.

Petit équipement pour la salle de physiothérapie

1	Fitball 75 cm	1 pièce
2	Fitball 65 cm	1 pièce
3	Fitball 55 cm	1 pièce
4	Ballon de pilates 25 cm	1 pièce
5	Boule de massage avec pointes 75 mm	1 pièce
6	Boule de massage lisse 6.5 cm	1 pièce
7	Double Boule de Massage 6.5x13.5 cm	1 pièce
8	Plateforme pas à pas	2 pièces
9	Tabouret de chaise sur roues sans dossier	10 pièces

Petit équipement pour la salle de physiothérapie

9	Ensemble de petits extenseurs (5 pièces)	1 ensemble
10	Ensemble de bandes extenseurs 200x15 cm (5 pièces)	1 ensemble
11	Ensemble d'extenseurs tubulaires (5 pièces)	1 ensemble
12	Ensemble de longs extenseurs (5 pièces)	1 ensemble
13	Haltères 0,5 kg	1 paire
14	Haltères 1 kg	1 paire
15	Haltères 2 kg	1 paire
16	Haltères 3 kg	1 paire

Petit équipement pour la salle de physiothérapie

17	Poids 0,5 kg	1 paire
18	Poids 1 kg	1 paire
19	Ceintures de réadaptation pour assurer les patients pendant la marche	4 pièces
20	Équilibrage de l'hémisphère de massage 160 mm	2 pièces
21	Équilibrage sur l'hémisphère BOSU	2 pièces
22	Coussin de Disque d'équilibre 33 mm	2 pièces
23	Rouleau de massage avec pointes 33x13 cm	1 pièce
24	Rouleau de massage lisse 90 cm	1 pièce

Petit équipement pour la salle de physiothérapie

25	Rouleau de massage lisse 45 cm	1 pièce
26	Tapis de sport	10 pièces
27	Bâtons de gymnastique 1 m	2 pièces
28	Bâtons de gymnastique 1,5 m	2 pièces
29	Bloc pour le yoga	6 pièces
30	<u>Les disques de glissement</u>	4 pièces
31	Espalier	3 pièces

A photograph of an occupational therapy session in a clinical setting. A therapist in green scrubs is assisting an elderly patient in using a walker. The patient is wearing a blue shirt and a dark skirt. The room features a checkered floor, a treatment table, a kitchen area with a microwave and sink, and various pieces of equipment. A text box in the upper right corner contains the text "Salle de thérapie occupationnelle".

Salle de thérapie
occupationnelle

Cuisine pour la salle de thérapie occupationnelle



Conçue pour aider le patient à restaurer la confiance perdue lors de l'exécution des activités ménagères : couper les légumes, laver les aliments, Faire du thé, etc. avec l'aide de classes dans un modèle spécial de la cuisine, le degré de dépendance du patient sur l'aide extérieure diminue.

Équipement de petite taille pour un espace de thérapie occupationnelle

Fourchette lourde et flexible pour thérapie occupationnelle	3 pièces
Cuillère lourde et flexible pour thérapie occupationnelle	3 pièces
Cuillère à thé lourde et flexible pour thérapie occupationnelle	3 pièces
Couteau lourd et incurvé pour thérapie occupationnelle	2 pièces
Aide à la préhension	2 pièces
Vaisselle pour thérapie occupationnelle	2 pièces

Équipement de petite taille pour un espace de thérapie occupationnelle

Tableau magnétique	2 pièces
Géotrieurs	2 pièces
Trieurs mathématiques	2 pièces
Cube trieur	2 pièces
Grandes pièces de puzzle (230/165 mm), puzzles à encastrer, puzzles logiques	
Pyramide	2 pièces
Lacets éducatifs, montres	2 pièces
Cartes Montessori, cartes Doman	

Équipement de petite taille pour un espace de thérapie occupationnelle

Jeux éducatifs de société	5 pièces
Dames	1 pièce
Échecs	1 pièce
Balles sensorielles de différentes tailles	
Blocs alphabétiques	2 pièces
Gants Saeboglove pour la réhabilitation de la motricité de la main	1 M, 2 L, 2XL/3 droits, 3 gauches
Grande gante pour la fixation des objets dans la main Inva	Gauche/droit

Cabinet de thérapie
psychologique



Meuble et équipement pour la thérapie psychologique

Ordinateur portable	1 pièce
Fauteuil	1 pièce
Canapé	1 pièce
Table basse	1 pièce
Étagère modulable	1 pièce

Meuble et équipement pour la thérapie psychologique

Grand miroir pour la thérapie miroir du patient 40 mini	1 pièce
Peintures gouache, aquarelle	5 emballages
Plasticine d'air de différentes couleurs	10 emballages
Sable cinétique multicolore	10 emballages
Pyramides de bois	2 pièces
Cubes de bois colorés	2 emballages
Cubes de Kohs	1 pièce

Meuble et équipement pour la thérapie psychologique

Cartes de test Rowena	1 pièce
Puzzle en bois – tri des formes «Tablettes de Seguin : motifs, figures, couleurs»	
Masseur éducatif pour les mains (motricité)	1 pièce
Pince pour le développement de la motricité fine des mains	1 pièce
Loto tactile	1 pièce
Crayons de couleur 24 couleurs	2 emballages
Feutres, marqueurs (couleurs, noirs (2 mm, 1 mm, 0,5 mm), dorés, argentés)	2 emballages

Meuble et équipement pour la thérapie psychologique

Pinceaux pour dessiner	2 emballages
Cadres en bois – puzzles des chiffres et des lettres	1 ensemble
Blocs de Dienes. Produit écologique	48 pièces 25 x 18 cm
Cartes Montessori	1 pièce
Tableau Montessori	1 pièce
Cartes selon de la méthode de Glenn Doman : légumes, fruits, baies	1 pièce
Puzzle labyrinthe en forme de lettre « N » pour passage à l'aveugle	1 pièce

Meuble et équipement pour la thérapie psychologique

Pochoirs en bois pour la créativité et le développement de la motricité fine	1 pièce
Carton coloré	3 emballages
Papier de couleur	3 emballages
Tableaux pour pâte à modeler	3 pièces
Bac à sable	2 pièces
Figurines pour la thérapie de sable	2 emballages
Balles de kinésiologie	2 ensembles
Sacs sensoriels	1 ensemble
Tableaux interhémisphériques	2 pièces
Instruments de musique (tambours, maracas, batterie, xylophone, bol chantant, handpan)	

Cabinet de thérapeute en langage et en parole



Meuble et équipement pour le cabinet de logopède

Miroir mural (50 x 100cm)	1 pièce
Miroir de table (60 x 80cm)	1 pièce
Miroir pour travail individuel (9x12cm)	1 pièce
Sondes logopédiques, spatules	8 pièces
Armoires	2 pièces
Table de papeterie	1 pièce
Jeux de société, jouets, jeux de construction	


Chambre d'hôpital pour le service de réhabilitation



Exigences pour la liste de l'équipement de la chambre du service de réhabilitation :

- ✓ Système de surveillance des signes physiologiques d'un patient – au moins 2
- ✓ Coussins antiescarres – au moins 6
- ✓ Matelas antiescarres – au moins 6
- ✓ Dispositifs de positionnement de différentes formes et tailles

Systeme de surveillance des signes physiologiques

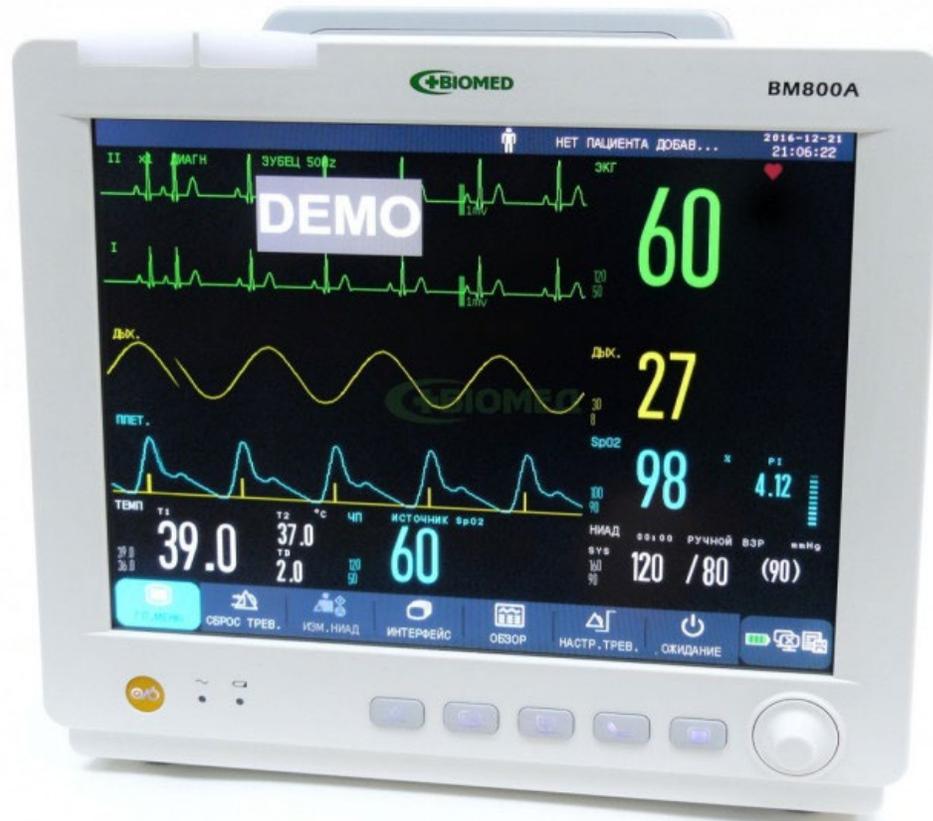

BIOMED
VM800A

Matelas antiescarres




Prévention et traitement des
escarres de stade 1 à 4.
Simulation des propriétés de
l'eau. Régulation individuelle
de la pression. Matériau : PVC.
Hauteur : 10 cm. Charge
maximale : 200 kg.

Coussins antiescarres



Les parties de cousins sont entièrement conformes à la forme du corps et éliminent la pression excessive sur les tissus.

Dispositifs de positionnement

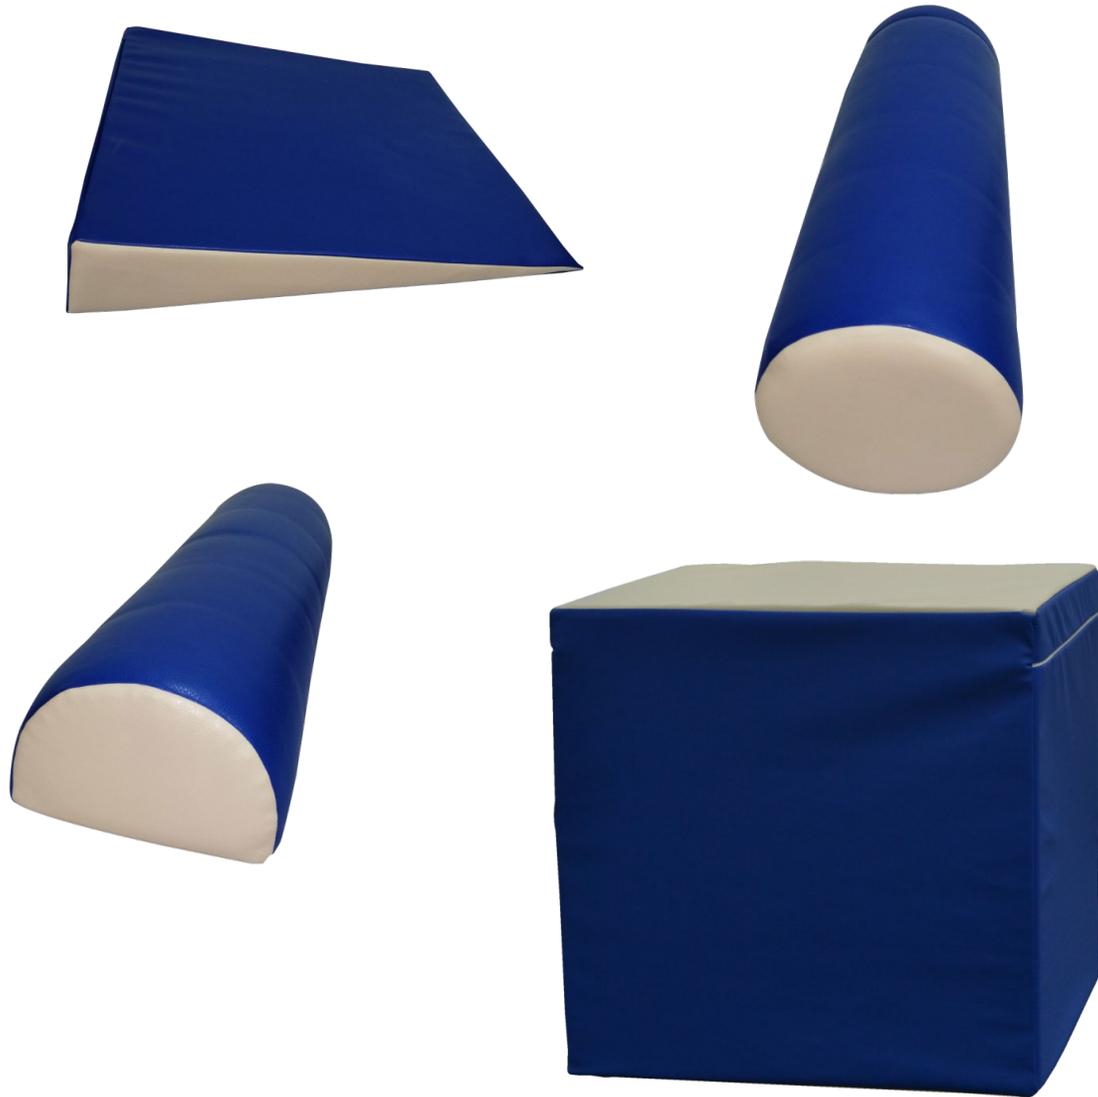

Wedge de positionnement

Rouleaux de positionnement

Demi-rouleaux pour le positionnement

Cube de positionnement

Table de chevet

Table de chevet Ridni Care KJT410



La table de chevet Ridni Care est conçue pour assister le patient en position couchée pour l'ergothérapie, l'orthophonie, etc.

Salles de bains inclusives



Toilette avec une lavabo et un douche

